





Grotte de Milandre Station mobile pH


créé le 14.09.17 18:09

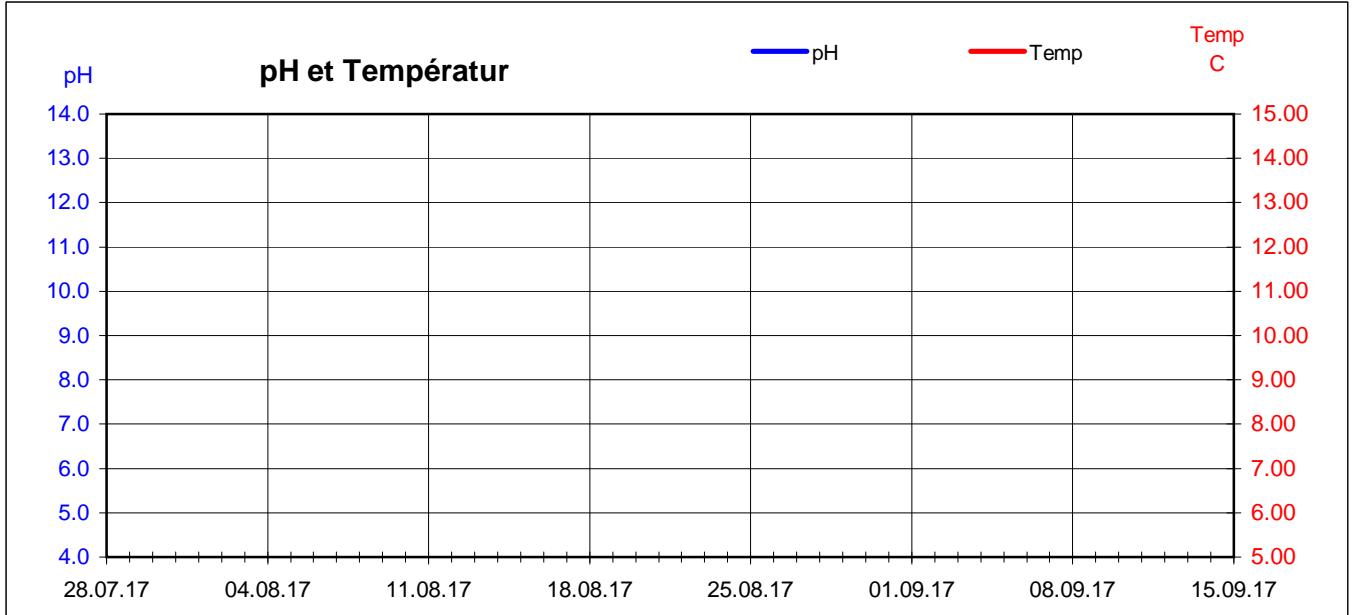

hier sollte mal jemand eine Beschreibung in Französisch machen....

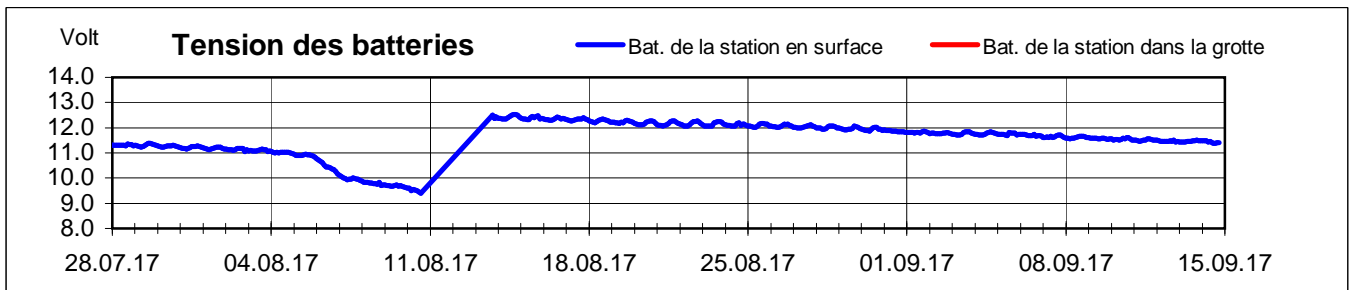

Toutes les 6 heures une mesure de la tension des batteries dans la grotte (courbe rouge) et à l'extérieur (courbe bleue) est effectuée. L'électronique fonctionne sans problème jusqu'à une tension de 9 volts. Comme il s'agit d'accus au plomb, il doivent être changés impérativement lorsque la tension atteint 10.5 volts.

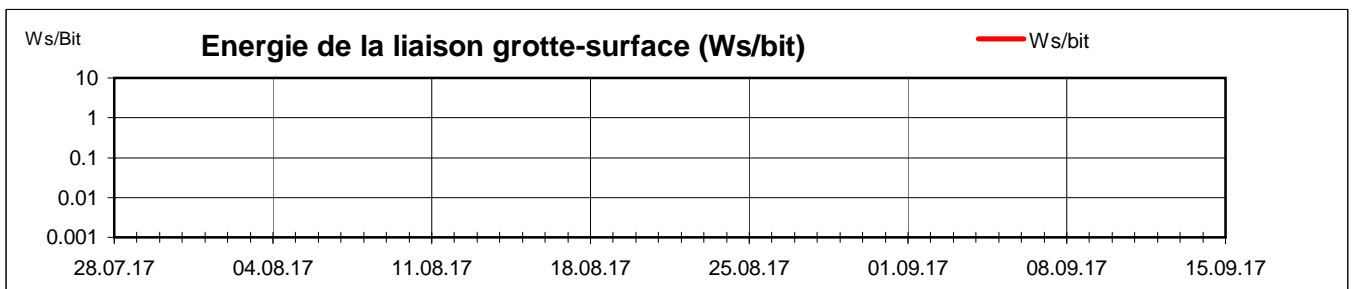

Die Daten werden alle 30 Minuten gemessen und mit Cave-Link-Geräten zur Oberflächenstation Maira übermittelt. Die Software kann die Energie, die zur Übertragung nötig ist, messen. Dargestellt wird die Energie, die benötigt wurde um 1 Bit zu übertragen. Da die Leistungsregelung einen beschränkten Umfang hat, ist die untere Grenze bei etwa 10mWs/bit. Es kann sein, dass die Werte mit bis zu 8 Stunden Verspätung angezeigt werden.

w